


色谱图和结果

进样信息

进样名称:	HR-01	运行时间 (min):	20.76
瓶号:	21	进样量:	0.20
进样类型:	未知	通道:	FrontDetector
校正级别:		波长:	n.a.
仪器方法:	test	带宽:	n.a.
处理方法:	test	稀释因子:	1.0000
进样日期/时间:	2022/04/06 14:30	样品重量:	1.0000

色谱图

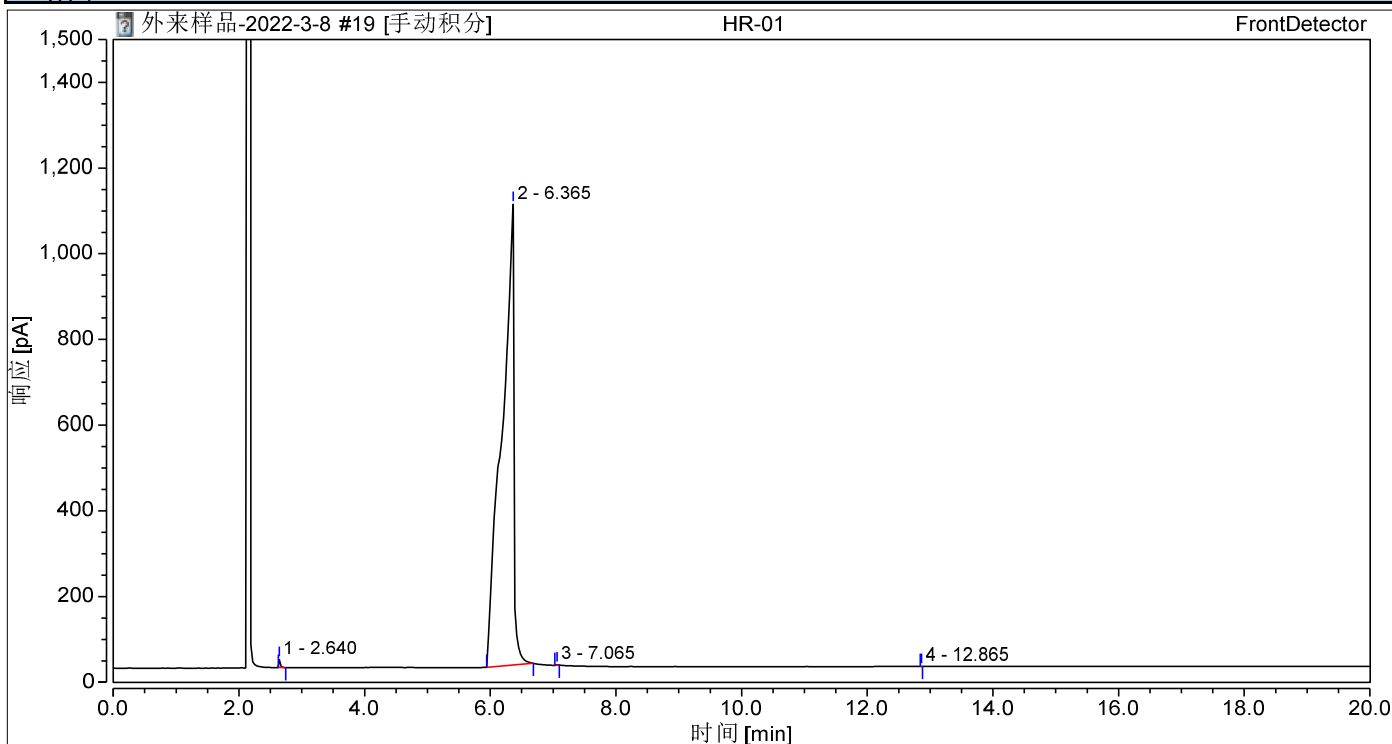

积分结果

序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 pA*min	峰高 pA	相对峰面积 %	相对峰高 %	样品量 n.a.
1		2.640	0.382	18.491	0.16	1.69	n.a.
2		6.365	236.304	1075.145	99.82	98.18	n.a.
3		7.065	0.050	1.188	0.02	0.11	n.a.
4		12.865	0.006	0.302	0.00	0.03	n.a.
总和:			236.742	1095.127	100.00	100.00	